



Erfassungsbogen

Bitte füllen Sie den Erfassungsbogen **vollständig** und gut **lesbar** aus. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Probenentnahme und zum Rückversand.

Ihre Daten


Name:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Analyseumfang Aluminium, Blei, Chrom, Kupfer, Zink, Nickel, Eisen



Rückversand

Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Probefbogen zusammen mit der Probe an folgende Adresse:



ICP Analytik GmbH & Co. KG | Brandenburger Platz 1 | D-24211 Preetz

Apotheken-Stempel

Datenblatt zur Probe

Bitte soweit sinnvoll und möglich vollständig ausfüllen.

eigene Probenbezeichnung

Adresse der Entnahmestelle

- identisch zu den Kundendaten
- abweichend:

Lage im Gebäude (z.B. EG, Küche, Einhebel-Mischarmatur)

- EG
- 1. OG
-
- Bad
- Küche
-
- Einhebel-Mischarmatur
- Zweigriff-Mischarmatur
- andere: 

Entnahmedatum / - Uhrzeit

..... :

Art der Wasserversorgung

- eigener Brunnen
- öffentliche Wasserversorgung
- Sonstige:

Wassertemperatur in °C

.....

- S2 Hausinstallation
- S1 Wasserhahn
- S0 Brunnenwasser



Bitte mit Hilfe der **Rückseite** eine **Probenahmestrategie** wählen.

[!] wird vom Labor ausgefüllt – bitte frei lassen

.....

Kundennummer

.....

Auftragsnummer

.....

Eingangsdatum

10056




Auftragstyp

Probenahmeanleitung

A) Probenahmestrategie

	Was möchten Sie untersuchen?	Wie müssen Sie die Probenahme durchführen?
S0	Das Wasser aus einem eigenen Brunnen oder das von einem öffentlichen Versorger?	Schritt 1 Das Wasser ablaufen lassen, bis sich die Wassertemperatur nicht mehr ändert. (ca. 3 l je Stockwerk)
		Schritt 2 Probe in Probegefäß abfüllen
S1	Das Wasser aus dem Wasserhahn?	Schritt 1 4 Stunden kein Wasser im Haus entnehmen (Stagnation)
		Schritt 2 Probe direkt ohne Vorlauf in das Probegefäß abfüllen.
S2	Das Wasser aus der Hausinstallation?	Schritt 1 4 Stunden kein Wasser im Haus entnehmen (Stagnation)
		Schritt 2 1 l Wasser vorlaufen lassen
		Schritt 3 Probe in Probegefäß abfüllen

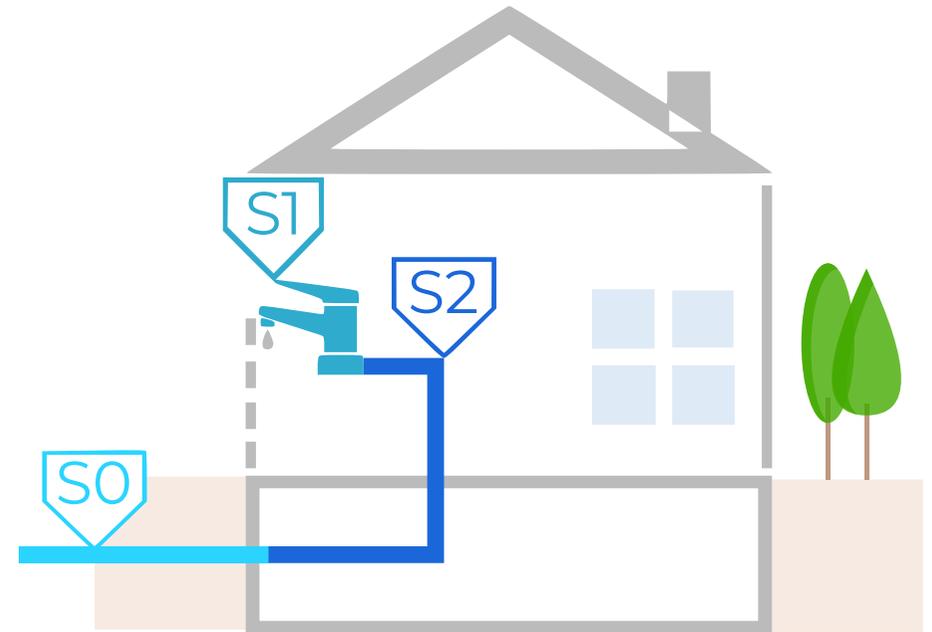

B) Praktische Durchführung

1.	Material	Probegefäß 30-50 ml bereitstellen
		ggf. einen 1 l Messbecher für den Vorlauf
2.	Auswahl	Probenahmestrategie wählen und ankreuzen
		Protokoll ausfüllen
3.	Beprobung	nach gewählter Probenahmestrategie vorgehen
		Das Probegefäß mit einem dünnen, gleichmäßigen Strahl randvoll befüllen.
4.	Versand	Probe wenn möglich kühl lagern
		Versand innerhalb von 24 Stunden durchführen